

**REGIONE
PIEMONTE**

Assessorato alla Sanità

ARPA

**Anagrafe Regionale dei
Prodotti Amministrabili**

Manuale Utente 1.0.0



Sommario

1. Introduzione	2
2. Profili utente.....	2
3. Dispositivi medici.....	2
3.1. ARPA-Ricerca Anagrafiche	2
3.1.1. Inserisci proposta anagrafica.....	4
3.2. Elenco dispositivi medici trovati.....	4
3.2.1. Visualizza	5
3.2.2. Modifica/Cambia stato	7
3.2.3. Esporta.....	7
4. Nature dispositivi medici	7
4.1. ARPA-Ricerca Nature	8
4.2. Elenco Nature	8
4.2.1. Esporta.....	9
4.2.2. Visualizza natura	9
4.2.3. Inserisci nuova natura	10

1. Introduzione

L'applicativo *Sistema Gestione Nomenclatori* (d'ora in poi abbreviato con SGN) consente la gestione dei nomenclatori. In quest'ottica si inserisce la gestione dei *Dispositivi medici* e *Nature dispositivi medici*. Tali nomenclatori consentono la raccolta e la gestione dei dati relativi ai dispositivi medici e alla loro natura.

2. Profili utente

Gli utenti abilitati all'utilizzo dell'applicativo sono di due tipologie: master e operatore.

Utente master: è abilitato alla visualizzazione, alla modifica, all'inserimento e alla validazione delle proposte anagrafiche. Può inoltre inserire e visualizzare nuove nature.

Utente operatore: è abilitato alla visualizzazione e all'inserimento delle proposte anagrafiche. Può inoltre visualizzare nuove nature.

3. Dispositivi medici

3.1.ARPA-Ricerca Anagrafiche

Per accedere alla pagina di *Ricerca Anagrafiche* si selezioni la voce *Nomenclatore* e poi *Dispositivi medici* (Figura 1).

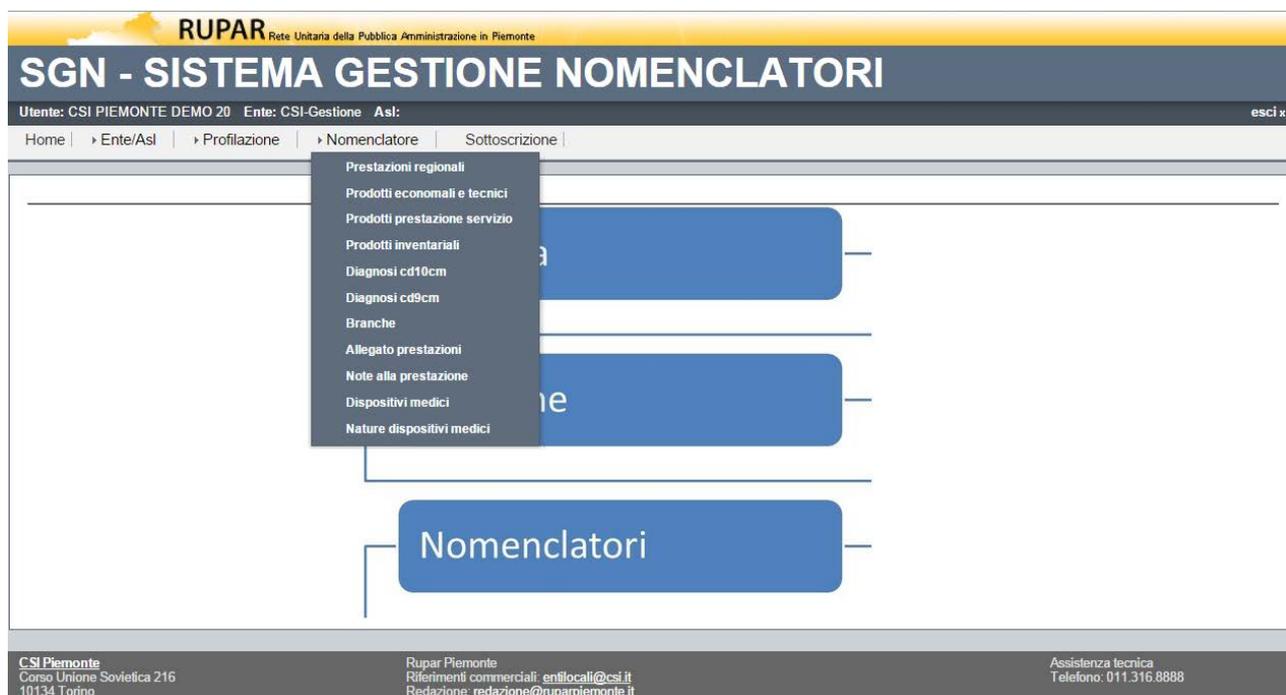


Figura 1

Compare la schermata di Figura 2.

Figura 2

Per effettuare la ricerca è necessario compilare i diversi campi. Selezionando la freccia del campo *CND di 1° livello* (Classificazione Nazionale Dispositivi medici) compare un menu a tendina, da cui si sceglie la voce interessata. A seconda della scelta si attivano i successivi livelli.

I campi a inserimento libero sono: *Descrizione unica*, *Codice anagrafica*, *Nome commerciale*, *Ref*, *Codice repertorio*, *Ragione sociale produttore*.

Lo voce *Stato del prodotto* presenta il seguente menu a tendina:

Proposta: indica che il dispositivo è stato inserito, ma ancora deve essere valutato dall'utente master. Quando si inserisce un nuovo dispositivo, questo è lo stato che viene assegnato automaticamente.

Validata: indica che il dispositivo è stato validato dall'utente master.

Respinta: indica che il dispositivo è stato respinto dall'utente master.

Chiusa: indica che il dispositivo non è più utilizzato: l'utente master ha provveduto a dichiararlo chiuso. Dopo tale assegnazione di stato, anche lo stesso utente master non può più procedere alla modifica del dispositivo, pertanto si raccomanda particolare attenzione durante questa fase.

Per visualizzare le informazioni commerciali si selezioni il tasto *Si*, come indicato in figura: *Si* *No*.

Per avviare la ricerca cliccare il tasto **Cerca dispositivo**. In seguito comparirà l'elenco dei dispositivi medici. Invece per cancellare i parametri di ricerca precedentemente selezionati cliccare **Annulla**.

3.1.1. Inserisci proposta anagrafica

Per inserire una nuova proposta anagrafica si selezioni il tasto **Inserisci proposta anagrafica**. Si aprirà la pagina di Figura 3.

Selezione cnd e natura del dispositivo	
CND di 1° livello: *	<input type="text"/>
CND di 2° livello:	<input type="text"/>
CND di 3° livello:	<input type="text"/>
CND di 4° livello:	<input type="text"/>
CND di 5° livello:	<input type="text"/>
CND di 6° livello:	<input type="text"/>
CND di 7° livello:	<input type="text"/>
Natura: *	<input type="text"/>

Dati anagrafici dispositivo medico	
Sede uso *	<input type="text"/>
Finalità *	<input type="text"/>
Specifiche tecniche *	<input type="text"/>
Dimensione	<input type="text"/>
Sterile *	<input type="text"/>
Uso *	<input type="text"/>
Conto economico *	<input type="text"/>
Disponibilità *	<input type="text"/>

Nota dispositivo medico	
Note	<input type="text"/>

Figura 3

I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco e sono: *CND di 1° livello*, *Natura*, *Sede uso*, *Finalità*, *Specifiche tecniche*, *Sterile*, *Uso*, *Conto economico*, *Disponibilità*.

Completate le varie voci, per salvare la proposta anagrafica si selezioni il tasto **Salva**. Per tornare al menu precedente cliccare **Torna alla ricerca**.

3.2. Elenco dispositivi medici trovati

Dopo aver impostato i parametri per la Ricerca Anagrafiche, comparirà l'elenco di Figura 4.

Dispositivi mediche commerciali

33 risultati trovati (4 pagine) 1 | 2 | 3 | 4 succ ▶ ultima

	Codice anagrafica	Codice ...	Descrizione unica	Stato	Natura	Conto	Ragione sociale	Nome comme...	Ref	Codice repertorio dis...
<input type="radio"/>	DA0100000178	A01010...	AGO IPODERMICO 27G...	PROPO...	AGO I...	3100...	CLINI-LAB SRL	...	4619	
<input type="radio"/>	DA0100000179	A01010...	AGO IPODERMICO 27G...	PROPO...	AGO I...	3100...	CLINI-LAB S.R.L.	...	4620	
<input type="radio"/>	DA0100000180	A01010...	AGO IPODERMICO 23G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31640	
<input type="radio"/>	DA0100000181	A01010...	AGO IPODERMICO 23G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31640	
<input type="radio"/>	DA0100000182	A01010...	AGO IPODERMICO 22G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31640	
<input type="radio"/>	DA0100000183	A01010...	AGO IPODERMICO 22G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31640	
<input type="radio"/>	DA0100000184	A01010...	AGO IPODERMICO 20G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31640	
<input type="radio"/>	DA0100000185	A01010...	AGO IPODERMICO 21G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31640	
<input type="radio"/>	DA0100000186	A01010...	AGO IPODERMICO 25G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31654	
<input type="radio"/>	DA0100000186	A01010...	AGO IPODERMICO 25G...	PROPO...	AGO I...	3100...	BECTON DIC...	3...	31654	

33 risultati trovati (4 pagine) 1 | 2 | 3 | 4 succ ▶ ultima

Figura 4

Per selezionare la pagina successiva si utilizzi **1 | 2 | 3 | 4 succ ▶ ultima**.

3.2.1. Visualizza

Per visualizzare un dispositivo medico si selezioni la voce corrispondente e si clicchi il tasto . Comparirà la schermata di Figura 5.

Dettaglio dispositivo medico			
Codice anagrafica	DA0100000178	Proponente	Demo 20 Demo 20
Descrizione unica	AGO IPODERMICO 27GA 13MM STER MON		
Codice CND	A01010101		
Descrizione CND	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA		
Natura	AGO IPODERMICO		
Sede d'uso		Finalità d'uso	
Specifiche tecniche		Dimensione	27GA 13MM
Sterile	STER	Uso	MON
Conto economico	3100110	Disponibilità	DISPONIBILE
Note			
Dettaglio dispositivo commerciale selezionato			
Ragione sociale	CLINI-LAB SRL	Nome commerciale	
REF	HN2713	Codice repertorio dispositivo	4619
Stato dispositivo medico			
Stato	PROPOSTA		
Elenco dispositivi commerciali associati al dispositivo medico selezionato			
Un risultato trovato.			pagina 1
	<u>Ragione sociale</u>	<u>Nome commerciale</u>	<u>Ref</u>
<input type="radio"/>	CLINI-LAB SRL		HN2713
			<u>Codice repertorio</u>
			4619
Un risultato trovato.			pagina 1
	scarica in Excel		scarica in PDF
<input type="button" value="Assegna dispositivo commerciale"/> <input type="button" value="Modifica dispositivo commerciale"/> <input type="button" value="Torna alla ricerca"/>			

Figura 5

Si ricorda che questa sezione non consente di modificare i dati.

Sinora non si sono presi in considerazione i dispositivi medici commerciali. Per assegnare un dispositivo medico commerciale al dispositivo medico di interesse, si selezioni il tasto

Assegna dispositivo commerciale

. Appare la schermata di Figura 6.

Codice anagrafica dispositivo	DA0000004888		
Ragione sociale *		Nome commerciale	
REF *		Codice repertorio dispositivo *	
<input type="button" value="Salva"/>	<input type="button" value="Torna alla ricerca"/>		

Figura 6

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

Per modificare un dispositivo medico commerciale già inserito, si selezioni il tasto  (vedi Figura 5 in basso). Appare la schermata in Figura 7.




Modifica dispositivo commerciale			
Codice anagrafica dispositivo	DA000004893		
Ragione sociale	fornitore 1	Nome commerciale	esempio 1
REF	123	Codice repertorio dispositivo	123
Salva Torna alla ricerca			

Figura 7

3.2.2. Modifica/Cambia stato

Per modificare lo stato del dispositivo si selezioni il tasto “Modifica cambia stato”. Nella tabella di Figura 8 è possibile cambiare lo stato.





Modifica stato del dispositivo			
Stato	PROPOSTA	Cambia stato in:	<input type="text"/>

Figura 8

Anche su questa pagina sono presenti le funzioni *Assegna dispositivo commerciale* e *Modifica dispositivo commerciale*.

3.2.3. Esporta

Per esportare l'elenco dei dispositivi medici di un determinato CDU o il documento di uno specifico dispositivo medico, selezionare i tasti  per formato Excel, e  per il formato PDF.

4. Nature dispositivi medici

Per poter inserire una nuova proposta anagrafica (vedi paragrafo 3.1.1) di un dispositivo medico, è necessario che la sua natura sia già presente all'interno del nomenclatore.

Nature dispositivi medici contiene l'anagrafica delle nature dei diversi dispositivi medici ed è accessibile dalla voce *Nomenclatore*, poi *Nature dispositivi medici*.

La pagina si compone di una tabella per effettuare le ricerche e di una sezione con l'elenco delle Nature presenti (vedi Figura 9).

The screenshot shows a web interface titled "ARPA - Ricerca Nature". It contains a search form with the following fields:

- CND di 1° livello: * (text input with a dropdown arrow)
- CND di 2° livello: (dropdown menu)
- CND di 3° livello: (dropdown menu)
- CND di 4° livello: (dropdown menu)
- CND di 5° livello: (dropdown menu)
- CND di 6° livello: (dropdown menu)
- CND di 7° livello: (dropdown menu)

Below the form is a message box with a yellow warning icon and the text "Non ci sono elementi da visualizzare." At the bottom of the interface are two buttons: "Visualizza" and "Inserisci nuova natura".

Figura 9

4.1.ARPA-Ricerca Nature


La tabella che consente la ricerca delle Nature dei dispositivi medici è riportata in Figura 10.

This screenshot is identical to Figure 9, showing the "ARPA - Ricerca Nature" search form with seven levels of classification (CND di 1° livello to CND di 7° livello) and the "Visualizza" and "Inserisci nuova natura" buttons.

Figura 10

Per poter ricercare le Nature dei dispositivi medici di interesse, è necessario compilare i livelli dei campi CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici). Tale funzione è a inserimento guidato: sarà possibile inserire direttamente l'informazione oppure selezionarla dal menu a tendina.

In automatico il sistema aggiornerà l'elenco delle Nature presenti per i livelli CND selezionati. Nel caso in cui i dati disponibili fossero molti, verrà visualizzata la seguente finestra

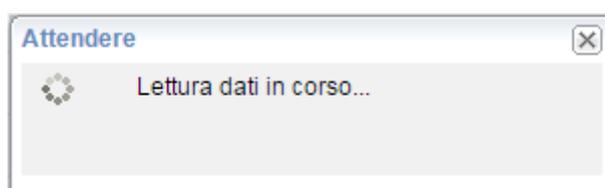

4.2.Elenco Nature

Dopo aver effettuato con successo la ricerca, la tabella che viene visualizzata sarà simile a quella in Figura 11.

Attraverso il pulsante **Torna alla ricerca** è possibile chiudere il *Dettaglio Natura* e ritornare alla pagina iniziale della ricerca.

4.2.3. Inserisci nuova natura

Per inserire una nuova natura è necessario selezionare il tasto **Inserisci nuova natura** (vedi Figura 11 in basso).

Comparirà la seguente videata:



The screenshot shows a web form for adding a new nature. At the top, there is a 'Cnd' field containing the text 'A0999 - CONTENITORI PER ORGANI - ALTRI'. Below it is a 'Descrizione natura' field. Underneath that is a 'Nota *' field. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Torna alla ricerca' and 'Salva'.

Figura 13

In essa è possibile inserire una descrizione della natura, mentre il campo *Nota* verrà visualizzato agli operatori in fase di inserimento di un dispositivo appartenente alla natura medesima.

Compilati tutti i campi, è possibile salvare la nuova natura selezionando il tasto **Salva**, mentre **Torna alla ricerca** riporta alla pagina della ricerca.

Al termine dell'inserimento il sistema visualizza l'elenco delle nature aggiornato.